



22988.1-78[†]


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СЧЕТЧИКИ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
НАЧАЛА СЧЕТА

ГОСТ 22988.1-78

Издание официальное

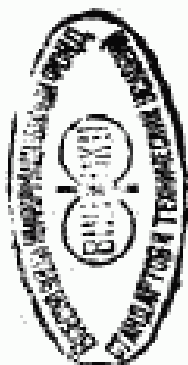

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

Редактор *Т. В. Сидорова*
Технический редактор *О. Н. Голубина*
Корректор *Ш. Рахмонова*

Сдано в набор 16.03.78 Подп. в печ. 26.04.78 0,25 л. д. 4000 знаков тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-387, Новоярмарковский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 258 Зак. 838

СЧЕТЧИКИ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ
Метод измерения напряжения начала счета
GAS CAUNTERS
Method of threshold voltage measurement

ГОСТ
22988.1—78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 февраля 1978 г. № 521 срок действия установлен

с 01.01.1979 г.
 до 01.01.1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


944
(10/88)

Настоящий стандарт распространяется на импульсные газоразрядные счетчики ионизирующих излучений (далее — счетчики) и устанавливает метод измерения напряжения начала счета.

Стандарт применяют совместно с ГОСТ 22988.0—78

1. АППАРАТУРА

1.1. Измерение напряжения начала счета проводят на измерительной установке, структурная схема которой приведена на чертеже. Электрическая схема включения сопротивления нагрузки, разделительной емкости приводится в стандартах на конкретные типы счетчиков.

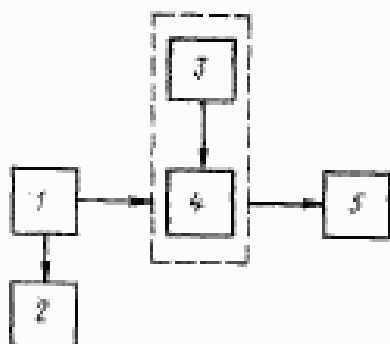

1 — источник постоянного тока;
 2 — вольтметр постоянного тока;
 3 — источник ионизирующего излучения;
 4 — счетчик газоразрядного излучения;
 5 — прибор регистрации импульсов

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1978

1.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Аппаратура	Требования
Прибор регистрации импульсов Источник постоянного тока Вольтметр постоянного тока Источник ионизирующего излучения	Порог чувствительности входа не должен превышать значение ряда, указанного в нормативно-технической документации на конкретные типы счетчиков: 0,05; 01; 0,2; 0,5; 1,0 В По ГОСТ 22988.0—78 Класс точности не ниже 1,5 Мощность экспозиционной дозы или плотности потока ионизирующего излучения на измерительных позициях, обеспечивающих скорость счета на плато не менее 20 имп./с, не должна превышать наибольшую рабочую мощность экспозиционной дозы или наибольшую рабочую плотность потока

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Включают аппаратуру при выведенном напряжении источника постоянного тока.

2.2. Устанавливают источник ионизирующего излучения на измерительную позицию.

2.3. Контактные элементы счетчиков протирают спиртом по ГОСТ 5962—67 и устанавливают счетчик на измерительную позицию.

2.4. Напряжение, подаваемое на счетчик, постепенно увеличивают, начиная с нулевого значения. Определяют напряжение, при котором прибор регистрации импульсов с порогом чувствительности, установленным в нормативно-технической документации на конкретные типы счетчиков, начинает регистрировать импульсы со скоростью не более 5 имп./с при скорости счета на плато не менее 20 имп./с.

Значение напряжения начала счета определяют по показанию вольтметра постоянного тока в момент начала регистрации импульсов, при этом относительная погрешность измерения напряжения начала счета должна находиться в пределах $\pm 3\%$ с доверительной вероятностью $P = 0,95$