



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ
ЭТАЛОН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ**

ГОСТ 8.547—86

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**



ГОСТ 8.547-86, Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная ...
State system for ensuring the uniformity of measurements. State primary standard and state verification schedule for means measuring relative humidity of gases

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛЬ

И. А. Соков

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л. К. Исаяв

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 1986 г. № 35

Государственная система обеспечения
единства измерений

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ**

State system for ensuring the uniformity of
measurements. State primary standard and state
verification schedule for means measuring relative
humidity of gases

**ГОСТ
8.547-86**

ОКСТУ 0008

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля
1986 г. № 35 срок введения установлен

с 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на государственный первичный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений относительной влажности газов и устанавливает назначение государственного первичного эталона единицы относительной влажности газов — процента (%), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы относительной влажности газов от государственного первичного эталона при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы относительной влажности газов и передачи размера единицы при помощи образцовых средств рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве, с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений относительной влажности газов должна быть положена единица, воспроизводимая указанным государственным эталоном.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1986

1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

генератор влажного газа на методе двух давлений для положительной температуры;

генератор влажного газа на методе двух давлений для отрицательной температуры;

набор прецизионных гигрометров для контроля за стабильностью работы генераторов влажного газа;

вычислительное устройство.

1.4. Диапазон значений относительной влажности газов, воспроизводимых эталоном, составляет $5\div 98\%$ при температуре от минус 60 до плюс 60 °С.

1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений S , не превышающим $0,05\%$. Неисключенная систематическая погрешность Θ не превышает $0,1\%$ при положительной и $0,2\%$ — при отрицательной температуре.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы относительной влажности газов с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы относительной влажности газов образцовым средствам измерений 1-го разряда методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют гигрометры относительной влажности в диапазоне измерений $5\div 100\%$ при температуре от минус 60 до плюс 60 °С.

2.1.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ образцовых гигрометров 1-го разряда составляют от 0,2 до 0,5% в зависимости от температуры.

2.1.3. Образцовые гигрометры 1-го разряда применяют для проверки образцовых динамических и статических генераторов влажного газа 2 и 3-го разрядов прямых измерений.

2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют динамические и статические генераторы влажного газа в диапазоне измерений $5\div 100\%$ при температуре от минус 60 до плюс 60 °С.

2.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ образцовых динамических и статических генераторов 2-го разряда составляют от 0,5 до 1% в зависимости от температуры.

2.2.3. Образцовые динамические и статические генераторы влажного газа 2-го разряда применяют для поверки образцовых 3-го разряда и высокоточных рабочих гигрометров методом прямых измерений.

2.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда применяют гигрометры и динамические и статические генераторы влажного газа в диапазоне измерений 5÷100% при температуре от минус 60 до плюс 60 °С.

2.3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ образцовых средств измерений 3-го разряда составляют от 1 до 5%.


2.3.3. Образцовые динамические и статические генераторы влажного газа 3-го разряда применяют для поверки рабочих гигрометров и гигрографов методом прямых измерений.

Образцовые гигрометры 3-го разряда применяют для поверки рабочих гигрометров и гигрографов непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют гигрометры и гигрографы различных типов в диапазоне измерений 5÷100% при температуре от минус 60 до плюс 60 °С.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений составляют от 1 до 15%.

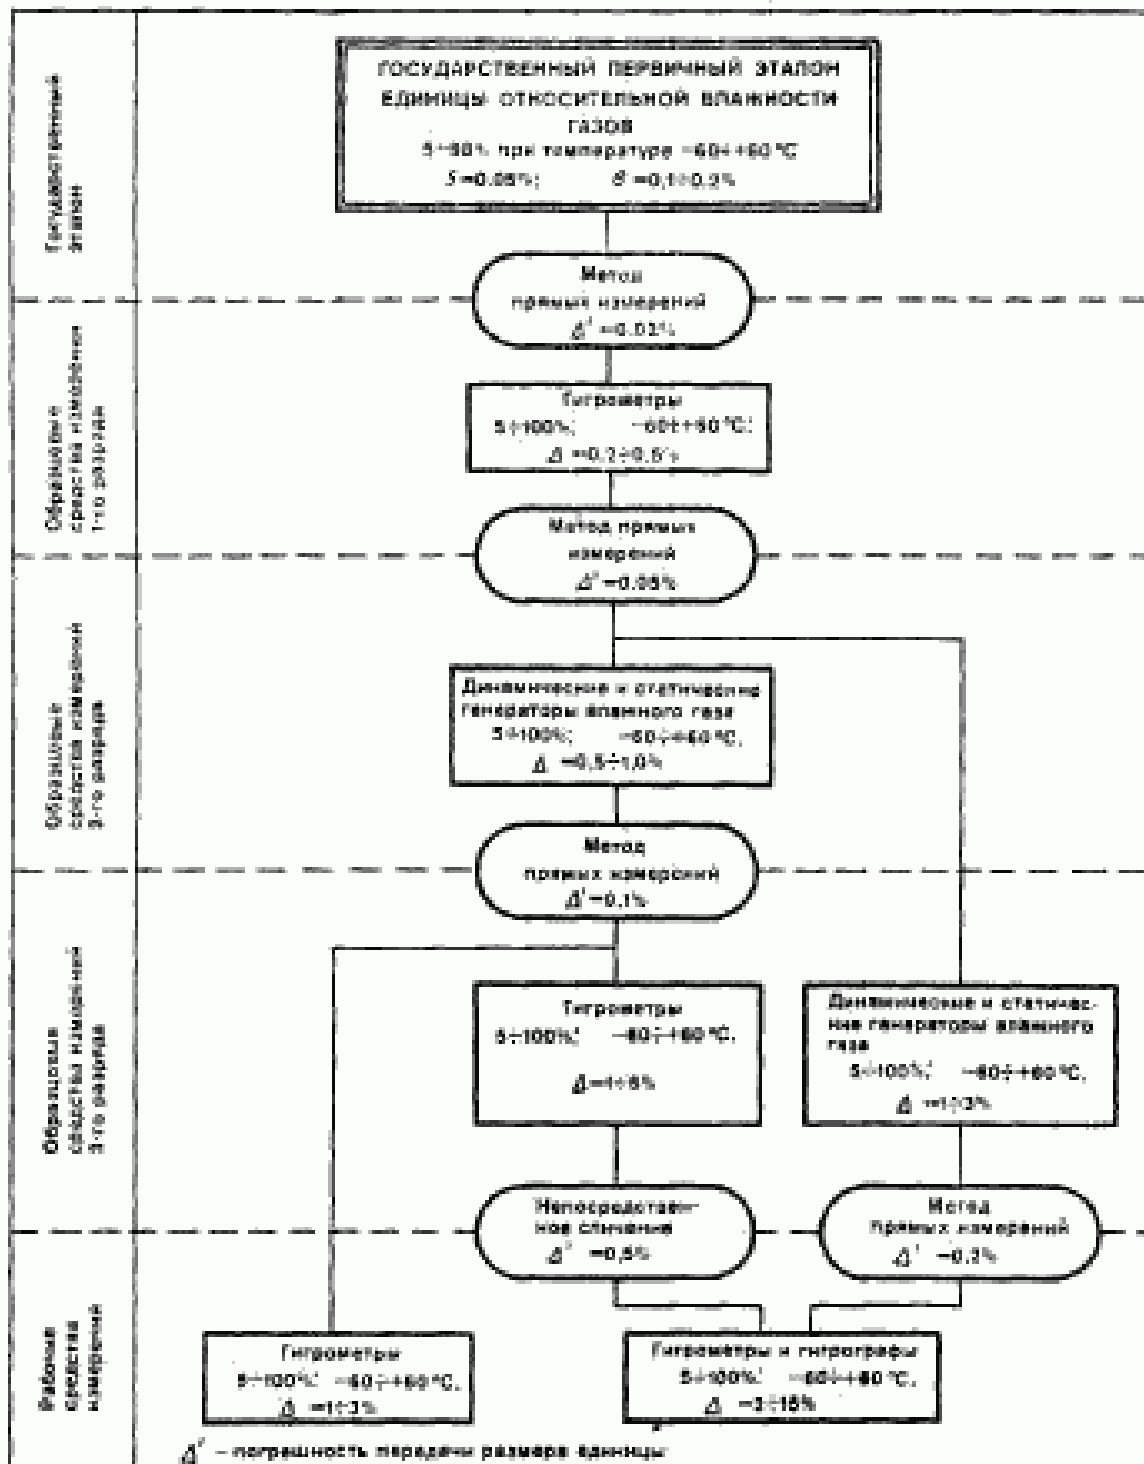

Редактор *В. Н. Шалова*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 12.06.86 Подп. в печ. 30.07.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,25 уч.-изд. л.
Тир. 16 000 Цена 3 коп.

